



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA
Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA**

Warszawa, 7 listopada 2019r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 15

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 21-W-D-10-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy zakresu nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z szwem ultradźwiękowym 3 ścieżkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy zakresu nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami samoprzylepnymi na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zakresu nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze standardowym prostym rękawem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy zakresu nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie: zewnętrzne opakowanie folia-papier oraz wewnętrzne owinięcie w serwetę włókninową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 6

Dotyczy zakresu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczych:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Ostona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przyklepne. Ostona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 7

Dotyczy zakresu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 8

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 9

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy zakresu 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy zakresu 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwu sekcijną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy zakresu 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta główna o rozmiarze 50 cm x 70 cm o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 108kPa

1 x Serweta z dwuwarstwowej włókniny foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem przylepnym 15 cm x 10 cm, z 4 przylepcami na rogach serwety, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 108 kPa

5 x Kompres gazowy 17 nitkowy 8 warstwowy o wymiarach 7,5cmx7,5cm

5 x Tupfer kula z gazy o śr. 3 cm

1 x Pean o dł 13,9cm

– 1 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowo-foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta, data ważności ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie nr 13

Dotyczy zakresu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 14

Dotyczy zakresu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą min. 4 rzędów ultradźwięków. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 rączniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: M-XXL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 15

Dotyczy zakresu nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby w celu zachowania wysokiego stopnia barierowości fartucha, rękawy na wysokości strefy krytycznej były tylko klejone, nie szyte? Standardowe szwy nie posiadają pełnej barierowości ze względu na powstawanie w materiale dziur podczas szycia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktów o ww. parametrach spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy zakresu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 1 fartucha **minimalnie** różniącego się od opisanego w SIWZ?

Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany w **opakowanie papier-folia**, czytelnie oznakowany (rozmiar fartucha), z długim terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznnej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m², szyty **trzyścieżkowym** szwem ultradźwiękowym, przeznaczony do standardowych zabiegów chirurgicznych z małą i średnią ilością płynów z zakładanymi połami, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniające aseptyczną aplikację z zachowaniem sterylności obszaru na plecach, w okolicy szyi zapięcia na rzep, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu **cztery** etykiety samoprzylepne z **min.** nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 17**Dotyczy zakresu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 1 fartucha minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany z dwoma ręcznikami do rąk, owinięty w papier krepowy i umieszczony w opakowaniu papier-folia, czytelnie oznakowany (rozmiar fartucha), z długim terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznego włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m², szyty trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym, przeznaczony do standardowych zabiegów chirurgicznych z małą i średnią ilością płynów z zakładanymi połami, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniające aseptyczną aplikację z zachowaniem sterylnego obszaru na plecach, w okolicy szyi zapięcia na rzep, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne z min. nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 18**Dotyczy zakresu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie nr 2 na pozycje, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, a także zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19**Dotyczy zakresu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, a także zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 1 na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego sterylny

Skład zestawu: serweta na stolik Mayo rozmiar 79 x 145 cm, serweta na stół do narzędzi rozmiar 150 x 190 cm, serweta na pacjentkę w kształcie lit T, rozmiar 180/250 x 330 cm z folią przylepną, osłaniającą miejsce operowane z wycięciem 18x16cm i torbą na płyny, wyposażoną w gąbkowy sztywnik oraz w dwa porty do ssaka, taśma przylepna do drenów rozmiar 9 x 50 cm, 4 serwetki do rąk rozmiar 30,5x34cm, owinięcie dla noworodka rozmiar 75x120 cm. Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H₂O

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 21**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 2 na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw brzuszno-kroczeniowy sterylne

Skład zestawu: serweta na stolik Mayo rozmiar 79 x 145 cm, serweta na stół do narzędzi rozmiar 150 x 190 cm, serweta brzuszno- kroczeniowa rozmiar 215/240x350cm, zintegrowana z nogawicami, kieszenią na płyny z filtrem i portem, z dwoma otworami operacyjnymi: brzuszny (przylepny), kroczeniowy (przylepny) z dodatkową osłoną do zasłaniania otworu, kiedy nie jest używany, 2 serwetki do rąk rozmiar 30,5x34cm, 2 taśmy mocujące 9x50cm. Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H₂O

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 22**Dotyczy zakresu nr 2 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 3 na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw ginekologiczny sterylne

Skład zestawu: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 2 ręczniki do rąk 30,5x,34cm, 1 rzep 2,5 x 30 cm, 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny, 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami, 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H₂O.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 23**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 4 na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw podstawowy

Skład zestawu: serweta na stolik Mayo rozmiar 79 x 145 cm, serweta na stół do narzędzi rozmiar 150 x 190 cm, serwety przylepne: rozmiar 150 x 240 cm - 1 szt., 180 x 180cm -1 szt., 75 x 90cm -2szt, taśma samoprzylepna rozmiar 9 x 50 cm, 2 serwetki do rąk rozmiar 30,5x34cm. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H₂O

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 24**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 5 serwety przylepnej rozmiar 75x90cm, wykonanej z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m²?

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 25**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 6 serwety przylepnej z laminatu dwuwarstwowego 60g/m², rozmiar 90x120cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 26**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8,9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2 poz. 8, 9 kieszeni o wymiarach 30x40cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 27**Dotyczy zakresu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do znieczulenia przewodowego

Skład zestawu: 1szt serweta z otworem przylepnym, 75x90cm, otwór 6x8cm – serweta 2w PE+PP, 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro 168kPa, 1szt narzędzie plastikowe (typu kocher) 14cm w kolorze niebieskim, 10szt kompresów 7,5cm x 7,5cm 4 warstwowe z włókniny 30 g/m², 1szt serweta podfoliowana typu Hospidrape 44g/m² stanowiąca owinięcie zestawu. Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z etykietą główną i 2 etykietami samoprzylepnymi, zawierającymi nr REF, LOT i datę ważności

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu ginekologicznego zawierającego 1 serwetkę do rąk, a serweta główna na pacjentkę jest w nieznacznie różniącym się rozmiarze – 290cm x 312cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 29**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu posiadającego serwetę przylepną w rozmiarze 170x175cm (zamiast 170x180cm). Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 30**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji serwety o wymiarach 75x90 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 31**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8 i 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 8 i 9 kieszeni nieznacznie różniących się parametrami – to jest o wymiarach 30x40 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 32**Dotyczy zakresu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych pojedynczo w torebkę papierowo-foliową, szyte dwuścieżkowym szwem ultradźwiękowym, z rękawem prostym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 33**Dotyczy zakresu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 34**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

element składowy	szt.	rozmiar
serweta T z otworem 32x35cm, workiem, folią chirurgiczną	1	325x250
podkład chłonny z pulpy celulozowej	1	90x60
serweta na stół instrumentarium	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej	2	40x20

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie nr 35**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

element składowy	szt.	rozmiar
Serweta z otworem w kształcie trapezu 28x20x19cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą	1	265x180
serweta	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrumentarium	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 36**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

element składowy	szt.	rozmiar
serweta z otworem 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1	245x180
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrumentarium	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Serweta główna wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 73g/m², nie zawierająca celulozy. Odporność na przenikanie cieczy min. 191 cm H₂O.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 37**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stół do narzędzi w rozm. 150x190cm oraz 2 serwetkami do rąk wykonanymi z niepylającej włókniny kompresowej w rozm. 20x40cm, z serwetkami głównymi wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m²? Reszta zgodna z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 38**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki w rozm. 90x75cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 39**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x150cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 40**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 39x54cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 41**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 35x42cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 42**Dotyczy zakresu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami o gramaturze min 56g/m² i odporności na przenikanie cieczy min 250 cm H₂O?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 43**Dotyczy zakresu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z wycięciem w postaci półkola w rozm. 20x10cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 44**Dotyczy zakresu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami w kształcie kuli w rozm. 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45**Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ jest właściwym załącznikiem? Wątpliwość powyższa powstała w związku z tym, iż w nagłówku tego załącznika widnieje odmienny numer postępowania do tego, który Zamawiający określił w SIWZ tj. 12-W-D-04-2018, zamiast właściwego 21-W-D-10-2019.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia iż właściwy numer załącznika nr 2 do SIWZ to 21-W-D-10-2019 (w załączeniu Załącznik nr 2 do SIWZ oznaczony właściwym numerem).

Pytanie nr 46**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1, 2, 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Zakresie nr 2, pozycja 1, 2, 3** serwety na stolik MAYO rozmiar 80x140 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 47**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Zakresie nr 2, pozycja 1** serwety na pacjentkę w kształcie lit. T, rozmiar ok. 200/250 x 315 cm z folią przylepną, osłaniającą miejsce operowane i torbą na płyny, wyposażoną w owinięty folią sztywnik oraz w jeden zawór do odprowadzania płynu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 48**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Zakresie nr 2, pozycja 4** zestawu podstawowego o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo rozmiar 80 x 140 cm *zamiast 80x145 cm*,
- serweta na stół do narzędzi rozmiar 150 x 200 cm *zamiast 140x190 cm*,
- serwety przylepne: rozmiar 150 x 240 cm - 1 szt., 150 x 200cm *zamiast 170x180 cm* -1 szt., 75 x 100cm *zamiast 75x90 cm* -2szt,
- taśma samoprzylepna rozmiar 10 x 50 cm *zamiast 9x50 cm*,
- 2 serwetki do rąk rozmiar 30 x 35 cm *zamiast 30x40 cm*.

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 - 62 g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 49**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Zakresie nr 2, pozycja 8** kieszeń przylepna rozmiar 50x60 cm *zamiast ok. 40x50 cm*.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 50**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Zakresie nr 2, pozycja 9** kieszeń przylepna rozmiar 40x30 cm (*zamiast ok. 40x50 cm*) z dwoma sekcjami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 51**Dotyczy zakresu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o poniższym opisie:

Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany w podwójne opakowanie (wewnątrz owinięcie w serwetę włókninową + opakowanie folia-papier), czytelnie oznakowany (rozmiar fartucha), z długim terminem ważności, wykonany z miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznego włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m², szyty minimum trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym, przeznaczony do standardowych zabiegów chirurgicznych z małą i średnią ilością płynów z zakładanymi połami, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniające aseptyczną aplikację z zachowaniem sterylnego obszaru na plecach, w okolicy szyi zapięcia na rzep, rękaw o kroju standardowym zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne z nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 52**Dotyczy zakresu nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o poniższym opisie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;
- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Serweta główna wykonana z materiału trzywarstwowego, chłonnego na całej powierzchni o gramaturze min. 62 g/m²
- Odporność na przenikanie cieczy głównej serwety min. 200cm H₂O

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 53**Dotyczy zakresu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczy o poniższym opisie:

- serweta o wymiarach 240 x 280cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, wyposażona w otwór w okolicy jamy brzusznej o wym. min. 30 x 30cm wypełniony folią

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa


centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

operacyjną, serweta wyposażona także w otwór o wym. 12 x 15cm w części kroczonej, otoczony taśmą lepną, z zabezpieczeniem w postaci osłony o wym. 20 x 25cm – 1 szt.

- osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm, wykonana z foli PE o grubości min. 0,05mm i warstwy chłonnej z wywinieniem umożliwiającym aseptyczne nakrycie stolika – 1 szt.
- taśma lepna włókninowa 9 x 49cm – 1 szt.
- kieszeń dwukomorowa, samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. min. 2 x 15 x 40cm – 1 szt.
- całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.
- Odporność na przenikanie cieczy: min. 185cm H₂O



Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 54

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o poniższym opisie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 2 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 serweta 100 x 100cm
- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm
- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów
- Odporność na przenikanie cieczy: min. 185cm H₂O.

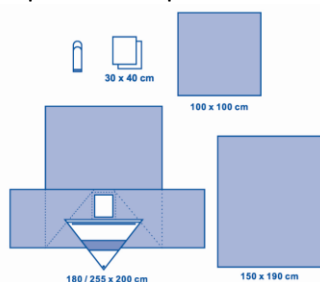

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 55

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym opisie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 30 x 40
- Odporność na przenikanie cieczy: min. 185cm H2O

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie nr 56

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100cm x 120cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy zakresu nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwusekcyjną przylepną w rozmiarze 2x15cmx40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Nowy termin składania ofert **13.11.2019r. godz. 10:00**

Nowy termin otwarcia ofert **13.11.2019r. godz. 10:30**

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

Załącznik nr 1 – modyfikacja z dnia 07-11-2019r. Załącznika nr 2 do SIWZ.